


9935 LogWareII 数据记录软件

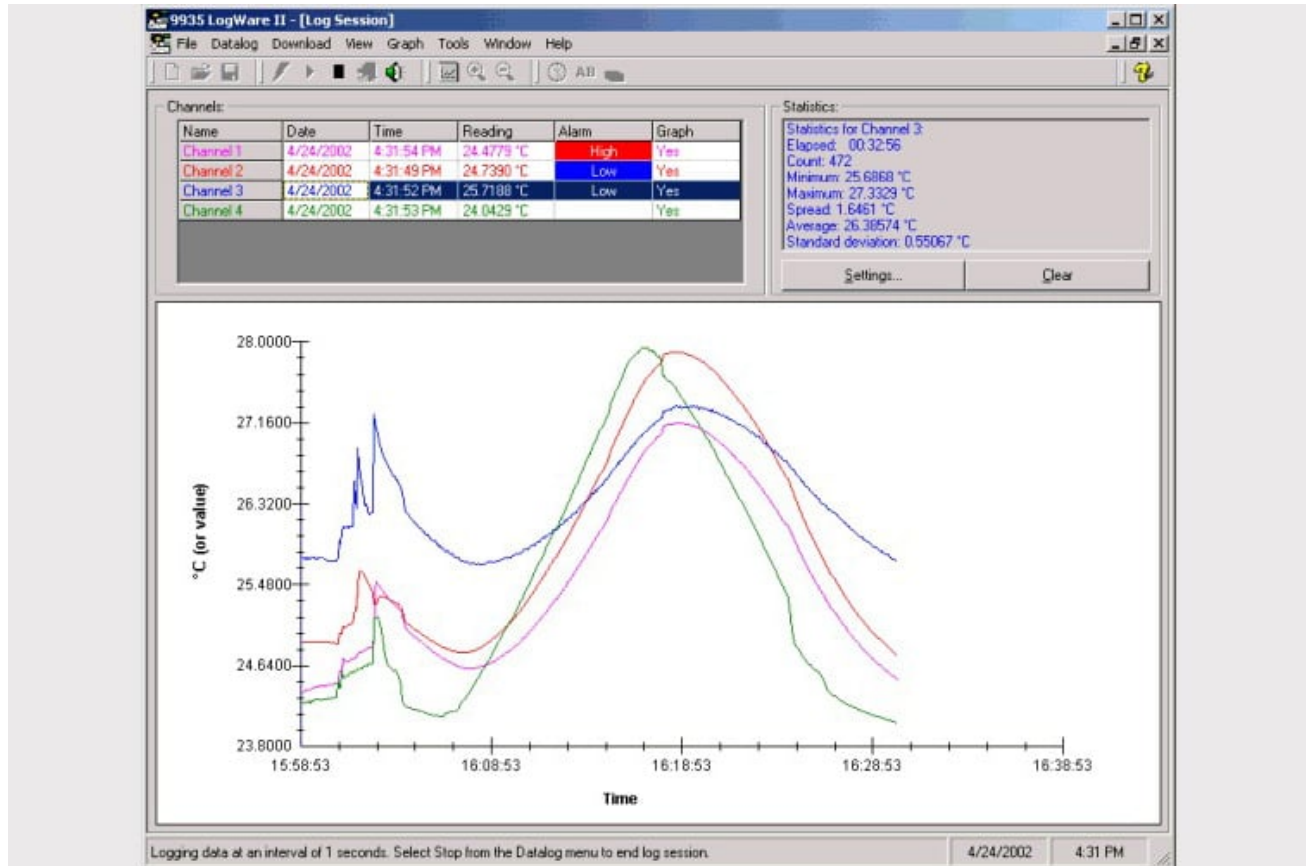

主要特性

- 可将所有 Fluke Calibration 的多通道温度计转变为实时数据记录器。
- 实时数据收集、统计、可定制图表。
- 选择开始/停止时间和采样间隔。
- 用户定义的可定制告警事件。
- 使用串行端口或 IR 端口，从温度计的记录和存储器下载数据。
- 读取/写入探头系数和温度计设置。

产品概述: 9935 LogWareII 数据记录软件

LogWare II 使您可以通过图表方式将数据采集至您的 PC，并将数据存储在文本文件中。同时，该软件还能自动对每个数据集执行统计功能。

虽然 LogWare II 也能采集电阻、电压、比率或其他数据，但该软件专门设计用于温度数据的采集。设定高级和低级告警条件，设置延迟启动时间，按照固定数目的读数或固定时间长度存储数据记录，在 1 秒到 60 小时之间设置采集周期，然后让软件按照您需要的方式记录您所需的数据。

在记录会话期间，您可以查看时间/数值趋势图中任何或所有数据集的数据，而数据点会存储至您 PC 上的文件中。在记录完成后，可以将图表输出至您的打印机，通过电子数据表查看测试点，或者重新查看相关的记录统计数值。使用 LogWare II，


您可以同时收集并查看 96 个探头的数据。

存储来自制冷器、烘箱、腔室以及任何您需要记录温度的设备读数，再将 *LogWare II* 与 PC 连接（通过标准串行电缆或红外线软件保护器），它会将每个记录会话分成单独的数据集。您无需在电子数据表内载入文本文件，并试着分清哪个记录会话对应哪些数据点。*LogWare II* 会为您完成全部这些操作。

LogWare II 还允许您更改读数装置配置。设定探头系数、将校准数据写入计量器、设定受密码保护的参数，以及访问其他专用于您的读数装置的工具，这些操作全部在您的 PC 上进行。

使用 *LogWare II* 可以发挥您的读数装置的功能。

型号

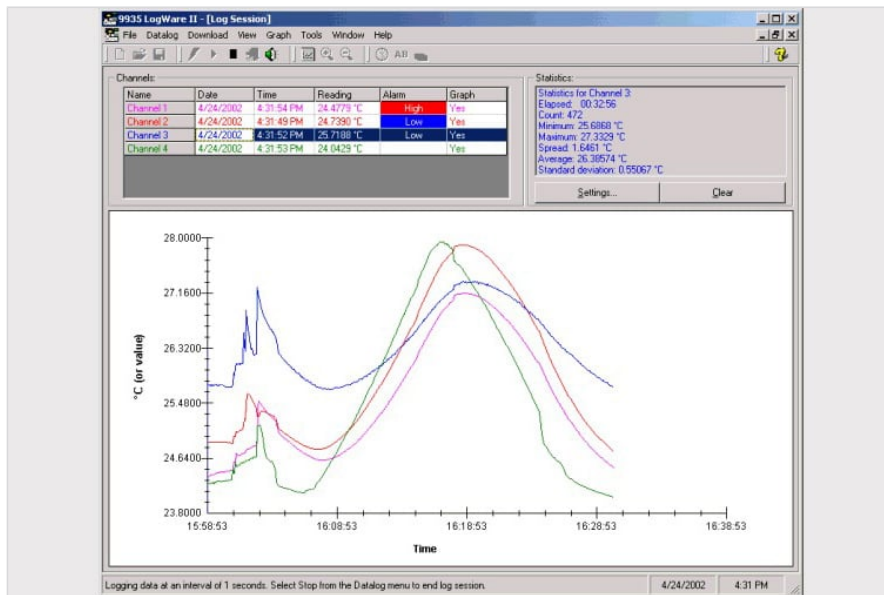

9935-S

LogWare II, 多通道, 单用户

9935-M

LogWare II, 多通道, 多用户



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克測試儀器（上海）有限公司 電話：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
06/2025
北京福祿克世祿儀器維修和服務有限公司 電
話：400-615-1563 未經許可，本文檔禁止修改
福祿克測試儀器（上海）有限公司上海維修中心 電
話：021-54402301, 021-54401908分機269
福祿克測試儀器（上海）有限公司深圳第一特約維修點
電話：0755-86337229